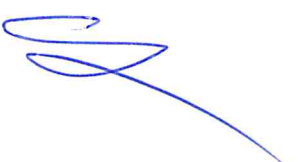


## Termica Colleferro Camino E2

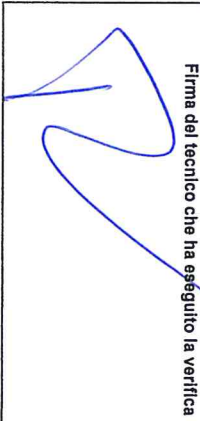
Verifica validità campo di taratura secondo EN14181 (par. 6.5)

Report prodotto il 26/02/2019 09:27:20



Dal 01/01/2019 al 26/02/2019 [[Ore di marcia impianto: 63]	CO	NOX
Numero di Medie Orarie Valide	63	63
Campo di taratura utilizzato [mg/Nm³]	42,9	145,9
Numero di Medie Orarie Valide NON comprese nel campo di taratura	0	0
Percentuale di Medie Orarie Valide NON comprese nel campo di taratura	0	0
Numero di settimane con il 5% dei valori maggiori del campo di taratura	0	0
Numero di settimane con il 40% dei valori maggiori del campo di taratura	0	0

REPORT QAL3 (UNI EN 14181)  
CARTA DI CONTROLLO CUSUM

Descrizione AMS		Termica Colferro Camino E2		Report nr.	
Costruttore	Siemens			Data	26/02/2019 09:22:01
Analizzatore	OXYMAT			Pag.	1 di 2
Serial number	N1-C6-352			Firma del tecnico che ha eseguito la verifica	
Componente	O2 tal quale E2				
Range di misura	0 - 20,95				
Unità di misura	vol. %				
N. Certificato bombola					

Verifica Di Precisione

VERIFICA DI ZERO	Data	Cmis	Crif	dt	SAMS	hs	ks	st	sp	N(s)t	Riduzione precisione
Verifica di taratura precedente	19/02/2019 08.51	-0.13	0	-0.13	0.23	0.37	0.10	0.00	-0.09	0	No
Verifica di taratura attuale	26/02/2019 08.52	-0.19	0	-0.19	0.23	0.37	0.10	0.00	-0.10	0	No

VERIFICA DI SPAN	Data	Cmis	Crif	dt	SAMS	hs	ks	st	sp	N(s)t	Riduzione precisione
Verifica di taratura precedente	19/02/2019 08.51	21.01	20.95	0.06	0.31	0.66	0.18	0.00	-0.18	0	No
Verifica di taratura attuale	26/02/2019 08.52	20.95	20.95	0.00	0.31	0.66	0.18	0.00	-0.18	0	No

NOTA: si ha riduzione di precisione se st >= hs

Legenda

Cmis	Concentrazione misurata	t	referimento alla verifica di taratura attuale
Crif	Concentrazione teorica	t-1	referimento alla verifica di taratura precedente
dt	Cmis - Crif	sp	st-1 + (dt - dt-1) ^ 2 / 2 - ks
SAMS	Scarto tipo del Sistema Automatico di Misurazione (da QAL1)	st	uguale a sp se sp > 0, altrimenti = 0
hs	6.9 * SAMS ^ 2	N(s)t	numero di letture successive fino al tempo t per le quali st si è mantenuto > 0
ks	1.85 * SAMS ^ 2		

REPORT QAL3 (UNI EN 14181)  
CARTA DI CONTROLLO CUSUM

Descrizione AMS	
Costruttore	Siemens
Analizzatore	OXYMAT
Serial number	N1-C6-352
Componente	O2 tal quale E2
Range di misura	0 - 20,95
Unità di misura	vol. %
N. Certificato bombola	

Termica Colferro Camino E2	
----------------------------	--

Report nr.	
Data	26/02/2019 09:22:01
Pag.	2 di 2
Firma del tecnico che ha eseguito la verifica	



Verifica Di Deriva

ZERO					SPAN									
SAMS	0,23	hx	0,66	kx	0,12	SAMS	0,31	hx	0,88	kx	0,16			
Crif		0			20,95									
LETTURA EFFETTIVA		VALORI CUSUM PRECEDENTI				LETTURA EFFETTIVA								
Cmis	0,00	SUM(pos)-1	0,00	N(pos)-1	0	Cmis	20,95	SUM(pos)-1	0,00	N(pos)-1	0			
		SUM(neg)-1	0,13	N(neg)-1	3			SUM(neg)-1	0,00	N(neg)-1	0			
dt = Cmis - Crif		-0,19			dt = Cmis - Crif									
SUM(pos)p = SUM(pos)-1 + dt - kx    e    SUM(neg)p = SUM(neg)-1 - dt - kx					SUM(pos)p = SUM(pos)-1 + dt - kx    e    SUM(neg)p = SUM(neg)-1 - dt - kx									
SUM(pos)p	-0,30	SUM(neg)p	0,20	SUM(pos)p								-0,15	SUM(neg)p	-0,16
se SUM(pos/neg)p > 0    =====>    SUM(pos/neg) = SUM(pos/neg)p    e    N(pos/neg) = N(pos/neg)-1 + 1														
se SUM(pos/neg)p <= 0    =====>    SUM(pos/neg) = 0    e    N(pos/neg) = 0														
SUM(pos)t		N(pos)t	0	VALORI CUSUM				SUM(pos)t	0,00	N(pos)t	0			
SUM(neg)t	0,20	N(neg)t	4					SUM(neg)t	0,00	N(neg)t	0			
se SUM(pos/neg)p > hx    =====>    IN PRESENZA DI DERIVA pos/neg														
NESSUNA DERIVA					ESITO VERIFICA		NESSUNA DERIVA							
Valore deriva (*)						Valore deriva (*)								
(*) Dopo ogni correzione strumentale della deriva vanno reimposti i seguenti valori CUSUM: SUM(pos/neg) = 0    N(pos/neg) = 0														

Legenda

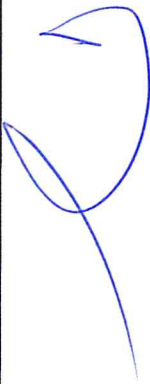
SAMS	Scarto tipo del Sistema Automatico di Misurazione (da QAL1)	t	referimento alla verifica di taratura attuale
hx	$2.85 \cdot \text{SAMS}$	t-1	referimento alla verifica di taratura precedente
kx	$0.501 \cdot \text{SAMS}$	SUM(pos)p	$\text{SUM}(\text{pos})t-1 + dt - kx$ (partendo dal valore iniziale SUM(pos) = 0)
Cmis	Concentrazione misurata	SUM(neg)p	$\text{SUM}(\text{neg})t-1 - dt - kx$ (partendo dal valore iniziale SUM(neg) = 0)
Crif	Concentrazione teorica	N(pos/neg)t	numero di letture successive fino al tempo t per le quali le somme SUM(pos/neg) si sono mantenute > 0



REPORT QAL3 (UNI EN 14181)  
CARTA DI CONTROLLO CUSUM

Descrizione AMS	
Costruttore	Siemens
Analizzatore	ULTRAMAT
Serial number	N1-C6-353
Componente	NO tal quale E2
Range di misura	0 - 250
Unità di misura	mg/Nm³
N. Certificato bombola	201607476

Termica Colferro Camlino E2

Report nr.	
Data	26/02/2019 09:20:57
Pag.	1 di 2
Firma del tecnico che ha eseguito la verifica	
	

Verifica Di Precisione

VERIFICA DI ZERO	Data	Cmis	Crif	dt	SAMS	hs	ks	st	sp	N(s)t	Riduzione precisione
Verifica di taratura precedente	19/02/2019 08.51	0.00	0	0.00	3	62.10	16.65	0.00	-16.65	0	No
Verifica di taratura attuale	26/02/2019 08.52	0.00	0	0.00	3	62.10	16.65	0.00	-16.65	0	No

VERIFICA DI SPAN	Data	Cmis	Crif	dt	SAMS	hs	ks	st	sp	N(s)t	Riduzione precisione
Verifica di taratura precedente	19/02/2019 08.51	198.93	201.93	-3.00	5	172.50	46.25	0.00	-45.99	0	No
Verifica di taratura attuale	26/02/2019 08.52	198.39	201.93	-3.54	5	172.50	46.25	0.00	-46.10	0	No

NOTA: si ha riduzione di precisione se st >= hs

Legenda

	Concentrazione misurata	t	referimento alla verifica di taratura attuale
Cmis	Concentrazione teorica	t-1	referimento alla verifica di taratura precedente
dt	Cmis - Crif	sp	st-1 + (dt - dt-1) ^ 2 / 2 - ks
SAMS	Scarto tipo del Sistema Automatico di Misurazione (da QAL1)	st	uguale a sp se sp > 0, altrimenti = 0
hs	6.9 * SAMS ^ 2	N(s)t	numero di letture successive fino al tempo t per le quali st si è mantenuto > 0
ks	1.85 * SAMS ^ 2		

REPORT QAL3 (UNI EN 14181)  
CARTA DI CONTROLLO CUSUM

Descrizione AMS	
Costruttore	Siemens
Analizzatore	ULTRAMAT
Serial number	N1-C6-353
Componente	NO tal quale E2
Range di misura	0 - 250
Unità di misura	mg/Nm³
N. Certificato bombola	201607476

Termica Colferro Camlino E2

Report nr.	
Data	26/02/2019 09:20:57
Pag.	2 di 2
Firma del tecnico che ha eseguito la verifica	

Verifica Di Deriva

ZERO					SPAN						
SAMS	3	hx	8.55	kx	1.50	SAMS	5	hx	14.25	kx	2.51
Crif		0			Crif		201.93				
LETTURA EFFETTIVA		VALORI CUSUM PRECEDENTI				LETTURA EFFETTIVA		VALORI CUSUM PRECEDENTI			
Cmis	0.00	SUM(pos)-1	0.00	N(pos)-1	0	Cmis	198.39	SUM(pos)-1	0.00	N(pos)-1	0
		SUM(neg)-1	0.00	N(neg)-1	0			SUM(neg)-1	3.75	N(neg)-1	5
dt = Cmis - Crif		0.00			dt = Cmis - Crif		-3.54				
SUM(pos)p = SUM(pos)-1 + dt - kx e SUM(neg)p = SUM(neg)-1 - dt - kx											
SUM(pos)p	-1.50	SUM(neg)p	-1.50	SUM(pos)p	-6.05	SUM(neg)p	4.79				
se SUM(pos/neg)p > 0 =====> SUM(pos/neg) = SUM(pos/neg)p e N(pos/neg) = N(pos/neg)-1 + 1											
se SUM(pos/neg)p <= 0 =====> SUM(pos/neg) = 0 e N(pos/neg) = 0											
SUM(pos)t		N(pos)t	0	VALORI CUSUM		SUM(pos)t	0.00	N(pos)t	0		
SUM(neg)t	0.00	N(neg)t	0			SUM(neg)t	4.79	N(neg)t	6		
se SUM(pos/neg)p > hx =====> IN PRESENZA DI DERIVA pos/neg											
NESSUNA DERIVA					NESSUNA DERIVA						
Valore deriva (*)		ESITO VERIFICA			Valore deriva (*)		NESSUNA DERIVA				
(*) Dopo ogni correzione strumentale della deriva vanno reimposti i seguenti valori CUSUM: SUM(pos/neg) = 0 N(pos/neg) = 0											

Legenda

SAMS	Scarto tipo del Sistema Automatico di Misurazione (da QAL1)	t	referimento alla verifica di taratura attuale
hx	$2.85 * SAMS$	t-1	referimento alla verifica di taratura precedente
kx	$0.501 * SAMS$	SUM(pos)p	SUM(pos)-1 + dt - kx (partendo dal valore iniziale SUM(pos)t = 0)
Cmis	Concentrazione misurata	SUM(neg)p	SUM(neg)-1 - dt - kx (partendo dal valore iniziale SUM(neg)t = 0)
Crit	Concentrazione teorica	N(pos/neg)t	numero di letture successive fino al tempo t per le quali le somme SUM(pos/neg) si sono mantenute > 0

REPORT QAL3 (UNI EN 14181)  
CARTA DI CONTROLLO CUSUM

Descrizione AMS	
Costruttore	Siemens
Analizzatore	ULTRAMAT
Serial number	N1-C6-353
Componente	CO tel quale E2
Range di misura	0 - 200
Unità di misura	mg/Nm³
N. Certificato bombola	201607476

Termica Colferro Camino E2

Report nr.	
Data	26/02/2019 09:20:07
Pag.	1 di 2
Firma del tecnico che ha eseguito la verifica	

Verifica Di Precisione

VERIFICA DI ZERO	Data	Cmis	Crif	dt	SAMS	hs	ks	st	sp	N(s)l	Riduzione precisione
Verifica di taratura precedente	19/02/2019 08.51	1.37	0	1.37	2	27.60	7.40	0.00	-7.33	0	No
Verifica di taratura attuale	26/02/2019 08.52	1.18	0	1.18	2	27.60	7.40	0.00	-7.38	0	No

VERIFICA DI SPAN	Data	Cmis	Crif	dt	SAMS	hs	ks	st	sp	N(s)l	Riduzione precisione
Verifica di taratura precedente	19/02/2019 08.51	157.59	161.12	-3.53	5.39	200.46	53.75	0.00	-53.71	0	No
Verifica di taratura attuale	26/02/2019 08.52	157.95	161.12	-3.17	5.39	200.46	53.75	0.00	-53.68	0	No

NOTA: si ha riduzione di precisione se st >= hs

Legenda

	Concentrazione misurata	t	referimento alla verifica di taratura attuale
Cmis	Concentrazione teorica	t-1	referimento alla verifica di taratura precedente
dt	Cmis - Crif	sp	st-1 + (dt - dt-1) ^ 2 / 2 - ks
SAMS	Scarto tipo del Sistema Automatico di Misurazione (da QAL1)	st	uguale a sp se sp > 0, altrimenti = 0
hs	6.9 * SAMS ^ 2	N(s)l	numero di letture successive fino al tempo t per le quali st si è mantenuto > 0
ks	1.85 * SAMS ^ 2		



REPORT QAL3 (UNI EN 14181)  
CARTA DI CONTROLLO CUSUM

Descrizione AMS	
Costruttore	Siemens
Analizzatore	ULTRAMAT
Serial number	N1-C6-353
Componente	CO tal quale E2
Range di misura	0 - 200
Unità di misura	mg/Nm³
N. Certificato bombola	201607476

Termica Colferro Camino E2

Report nr.	
Data	26/02/2019 09:20:07
Pag.	2 di 2
Firma del tecnico che ha eseguito la verifica	

Verifica Di Deriva

ZERO										SPAN									
SAMS	2	hx	5.70	kx	1.00	SAMS	5.39	hx	15.36	kx	2.70								
Crif		0								Crif		161.12							
LETTURA EFFETTIVA		VALORI CUSUM PRECEDENTI								LETTURA EFFETTIVA		VALORI CUSUM PRECEDENTI							
Cmis	3.62	SUM(pos)-1	3.44	N(pos)-1	6	Cmis	157.95	SUM(pos)-1	0.00	N(pos)-1	0								
		SUM(neg)-1	0.00	N(neg)-1	0			SUM(neg)-1	2.13	N(neg)-1	3								
dt = Cmis - Crif		1.18								dt = Cmis - Crif		-3.17							
SUM(pos)p = SUM(pos)-1 + dt - kx e SUM(neg)p = SUM(neg)-1 - dt - kx																			
SUM(pos)p	3.62	SUM(neg)p	-2.18							SUM(pos)p	-5.87	SUM(neg)p	2.60						
se SUM(pos/neg)p > 0 =====> SUM(pos/neg) = SUM(pos/neg)p e N(pos/neg) = N(pos/neg)-1 + 1																			
se SUM(pos/neg)p <= 0 =====> SUM(pos/neg) = 0 e N(pos/neg) = 0																			
SUM(pos)l		N(pos)l	7	VALORI CUSUM						SUM(pos)l	0.00	N(pos)l	0						
SUM(neg)l	0.00	N(neg)l	0							SUM(neg)l	2.60	N(neg)l	4						
se SUM(pos/neg)p > hx =====> IN PRESENZA DI DERIVA, pos/neg																			
NESSUNA DERIVA										NESSUNA DERIVA									
Valore deriva (*)		ESITO VERIFICA		Valore deriva (*)						NESSUNA DERIVA									
(*) Dopo ogni correzione strumentale della deriva vanno reimposti i seguenti valori CUSUM: SUM(pos/neg) = 0 N(pos/neg) = 0																			

Legenda

SAMS	Scarto tipo del Sistema Automatico di Misurazione (da QAL1)	t	referimento alla verifica di taratura attuale
hx	$2.85 * SAMS$	t-1	referimento alla verifica di taratura precedente
kx	$0.501 * SAMS$	SUM(pos)p	SUM(pos)-1 + dt - kx (partendo dal valore iniziale SUM(pos) = 0)
Cmis	Concentrazione misurata	SUM(neg)p	SUM(neg)-1 - dt - kx (partendo dal valore iniziale SUM(neg) = 0)
Crit	Concentrazione teorica	N(pos/neg)t	numero di letture successive fino al tempo t per le quali le somme SUM(pos/neg) si sono mantenute > 0